



校正証明書番号 C16111101

## 校正証明書


依頼者	株式会社 石蔵商店
住所	福岡県福岡市博多区須崎町3番6号
品名	鋳鉄製分銅
型式	枕型
能力	20kg
機器番号	校正結果に示す
製造者	株式会社石蔵商店
試験項目	質量校正試験
試験方法	質量標準器等との比較校正
試験室の条件	温度 22℃ 湿度 45%
試験年月日	平成 28 年 11 月 11 日

試験の結果は別紙のとおりであることを証明します。

平成 28 年 11 月 11 日

〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜2丁目5-1

株式会社石蔵商店



事前の承認なしに、この成績書の一部のみを複製して使用することを禁じます。



校正証明書番号 C16111101

## 校正結果

### 1. 試験結果及び校正値

この検査成績書は弊社の社内標準に基づき、国立研究開発法人産業技術総合研究所とトレーサブルな標準分銅を用いて行いました。

種	類	鋳鉄製枕型分銅
能	力	20kg
精	度	OIML M1 級

### 検査結果

器物番号	表す量	校正前器差	校正後器差	OIML M1 級の公差
H1	20kg	-150mg	0	±1000mg
H2	20kg	0	0	±1000mg
H3	20kg	0	0	±1000mg
H4	20kg	-100mg	0	±1000mg
H5	20kg	-50mg	-50mg	±1000mg
H6	20kg	-100mg	0	±1000mg
H7	20kg	0	0	±1000mg

### 2. 校正に使用した標準分銅

1 級基準分銅 F2 級      20kg      器物番号 1

### 3. 有効期限

平成 28 年 11 月 11 日～平成 29 年 5 月 10 日

平成 28 年 11 月 11 日

株式会社 石蔵商店 新宮工場  
福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜 2 丁目 5-1  
TEL 092-963-1654



# 基準器検査成績書

13福第F-11号

## 質量基準器

種類 一級基準分銅

型式又は能力 20kg～1mg

器物番号 1, 16

(1) 器差

表す質量	器差
No.1 20kg	0
No.16 10kg	0
No.16 5kg	0
No.16 2kg	0
No.16 1kg	0
No.16 500g	0
No.16 200g	0
No.16 100g	0
No.16 50g	0
No.16 10g	0
No.16 5g	0
No.16 2g	0
No.16 1g	0

表す質量	器差
No.16 500mg	0
No.16 200mg	0
No.16 100mg 1, 2	0
No.16 50mg	0
No.16 20mg	0
No.16 10mg 1, 2	0
No.16 5mg	0
No.16 2mg	0
No.16 1mg	0
No.16 1mg	0
以下余白	

(2) 器差の補正の方法 真実の質量は表す質量から器差を減じて求める。

(3) 有効期間 平成25年6月28日から平成30年6月27日まで

(4) 用途又は使用の方法

(5) その他 器差0とは基準器公差内であることを示す。  
合格個数：25個

平成25年6月27日

福岡県計量検定所長






校正証明書番号 C 16111101


発行日 平成28年11月11日

株式会社 石蔵商店 新宮工場  
福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜2丁目5-1



## トレーサビリティ体系図(質量関係)

使用している質量標準器は下記の体系により国家標準にトレーサブルです。

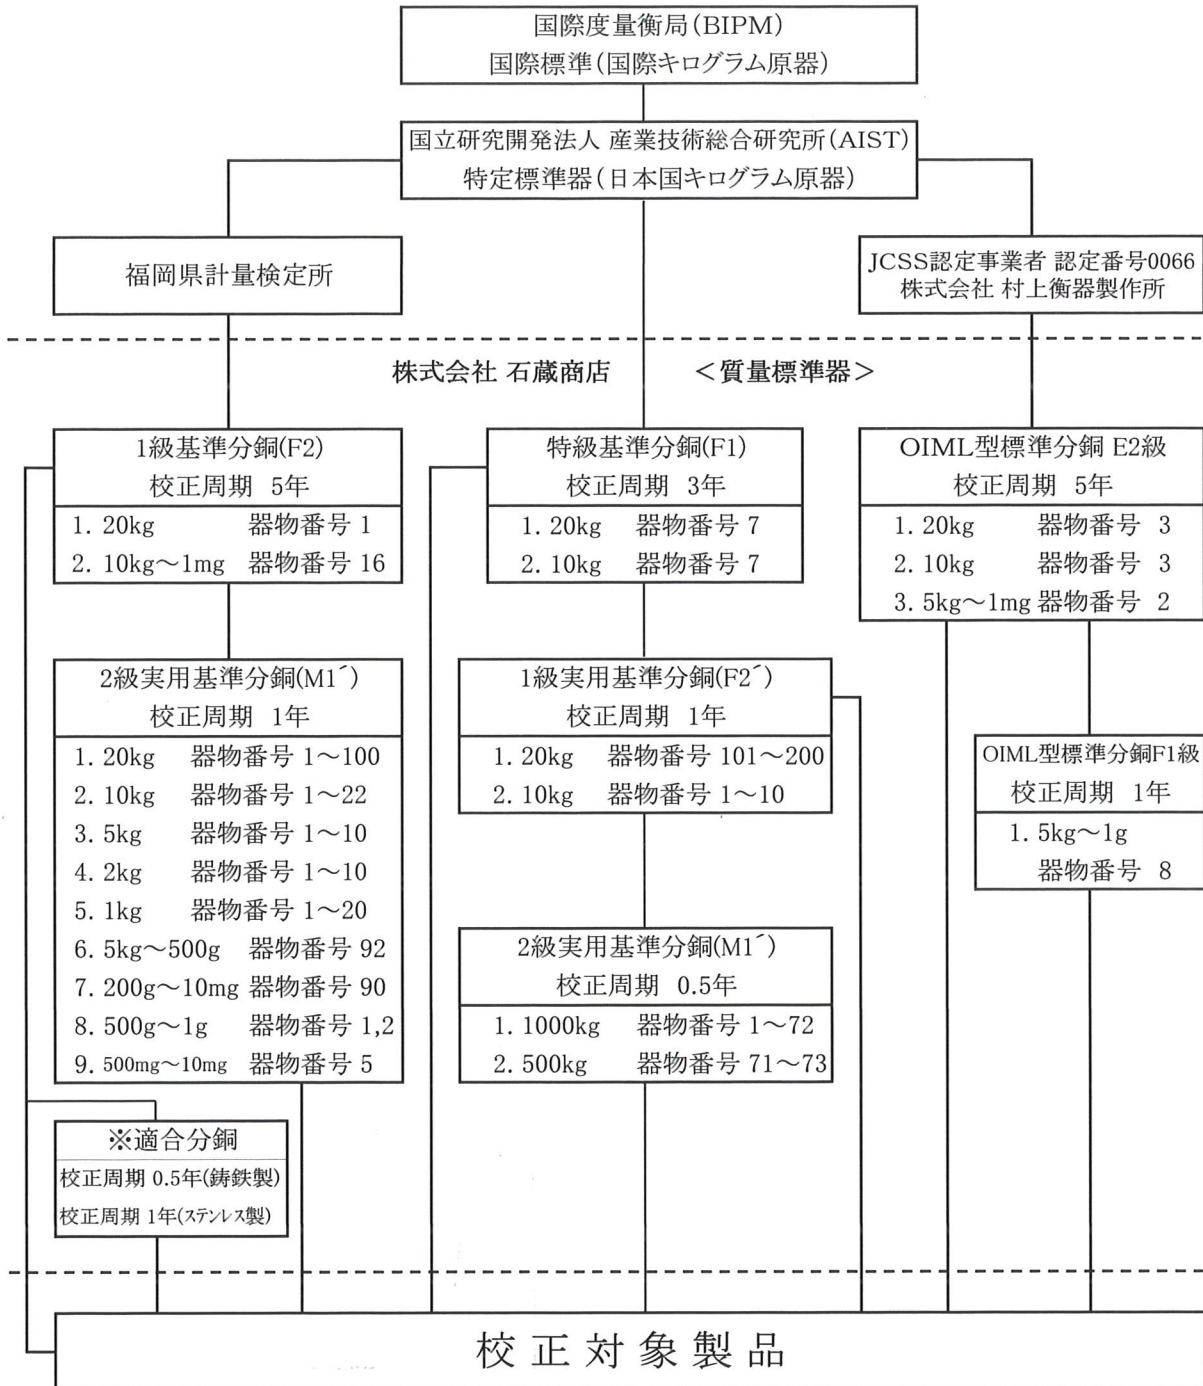

※適合分銅とは、計量法・基準器検査規則で定められた内容に適合した事を弊社が保証する分銅

No, 1610C-2