



校正証明書番号 ※※※※※※※※※※

校正証明書

依頼者 株式会社 石蔵商店 殿

校正日 ※※※※年※※月※※日

校正結果 検査成績書のとおり

製造メーカー	品名	型式	製造番号
石蔵商店	デジタル台はかり	IS-150	※※※※※

上記製品は、別紙の検査成績書のとおり校正された事を証明致します。

尚、検査に使用した質量標準器は、国家標準もしくは国際標準にトレーサブルです。

発行日 ※※※※年※※月※※日

株式会社 石蔵商店 新宮工場
福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜2丁目5-1



検査成績書

承認	検査

検査年月日	※※※※年※※月※※日	検査者名	株式会社 石蔵商店	
メーカー名	石蔵商店	ひょう量	150kg	検定証印(年月) <input checked="" type="checkbox"/> 有 (※※※※) <input type="checkbox"/> 無
品名	デジタル台ばかり	目量	0.05kg	検査の種類 <input type="checkbox"/> 定期検査 <input checked="" type="checkbox"/> 自主検査
型式	IS-150	使用地区	福岡県	精度等級 <input type="checkbox"/> I級 <input type="checkbox"/> II級 <input type="checkbox"/> III級 (証印ありの場合) <input type="checkbox"/> ()
器物番号	※※※※※	重力加速度	9.794~9.797 m/s ²	型式承認番号 第※※※※号

1. 器差検査

負荷重量	公差	器差 (kg)	
		行	戻
0 kg	± 0.05	0	0
1 kg	± 0.05	0	0
25 kg	± 0.05	0	0
50 kg	± 0.10	0	0
75 kg	± 0.10	0	0
100 kg	± 0.10	0	0
150 kg	± 0.15	0	-

2. 四隅検査

< 角皿 >

指示器差 (kg)

中央	0
①	0
②	0
③	0
④	0

< 丸皿 >

負荷重量 50 (kg)
公差 ± 0.10 (kg)

3. 繰り返し検査

表示値	無負荷時 (kg)	荷重時 (kg)
1回目	0.00	75.00
2回目	0.00	75.00
3回目	0.00	75.00

負荷重量 75 (kg)
公差 ± 0.10 (kg)

公差

目量等で表した質量の値	検定公差	使用公差
0以上500以下	0.5目量	1目量
500を超え2000以下	1目量	2目量
2000を超え10000以下	1.5目量	3目量

4. 感じ検査

感量	50 (g)
使用下限	<input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
1/2ひょう量	<input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
ひょう量付近	<input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否

備考

- 校正証明書番号 ※※※※※※※※
- 判定はIII級の精度にて行っております。

検査結果 良 否



校正証明書番号 ※※※※※※※※

使用分銅報告書

貴社の計量器の検査に用いた分銅は以下の通り。

社内検査は弊社の作業標準に基づき、国立研究開発法人産業技術総合研究所とトレーサブルな質量標準器を用いて行いました。

種類 ; 実用基準分銅

能力 ; 20kg, 10kg, 5kg, 1kg, 50g

精度 ; 2級基準分銅と同等

表す量	形状	数量	器物番号	器差	公差
20 kg	枕型	7	1~7	0	± 1 g
10 kg	枕型	1	1	0	± 500 mg
5 kg	枕型	1	1	0	± 250 mg
1 kg	枕型	1	1	0	± 50 mg
50 g	円筒型	1	90	0	± 3.0 mg

※器差0とは基準器公差内であることを示す。

校正日 ; ※※※※年※※月※※日 20kg

有効期限 ; 校正日より1年間

校正日 ; ※※※※年※※月※※日 10kg, 5kg, 1kg

有効期限 ; 校正日より1年間

校正日 ; ※※※※年※※月※※日 50g

有効期限 ; 校正日より1年間

上記標準分銅の校正に使用した質量標準器は下記の通りです。

1級基準分銅 20kg

器物番号 1


1級基準分銅 10kg, 5kg, 1kg, 50g

器物番号 16

発行日 ※※※※年※※月※※日

株式会社 石蔵商店 新宮工場
福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜2丁目5-1

TEL (092) 963 - 1654






校正証明書番号 ※※※※※※※※※※


発行日 ※※※※年※※月※※日

株式会社 石蔵商店 新宮工場
福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜2丁目5-1



トレーサビリティ体系図(質量関係)

使用している質量標準器は下記の体系により国家標準にトレーサブルです。

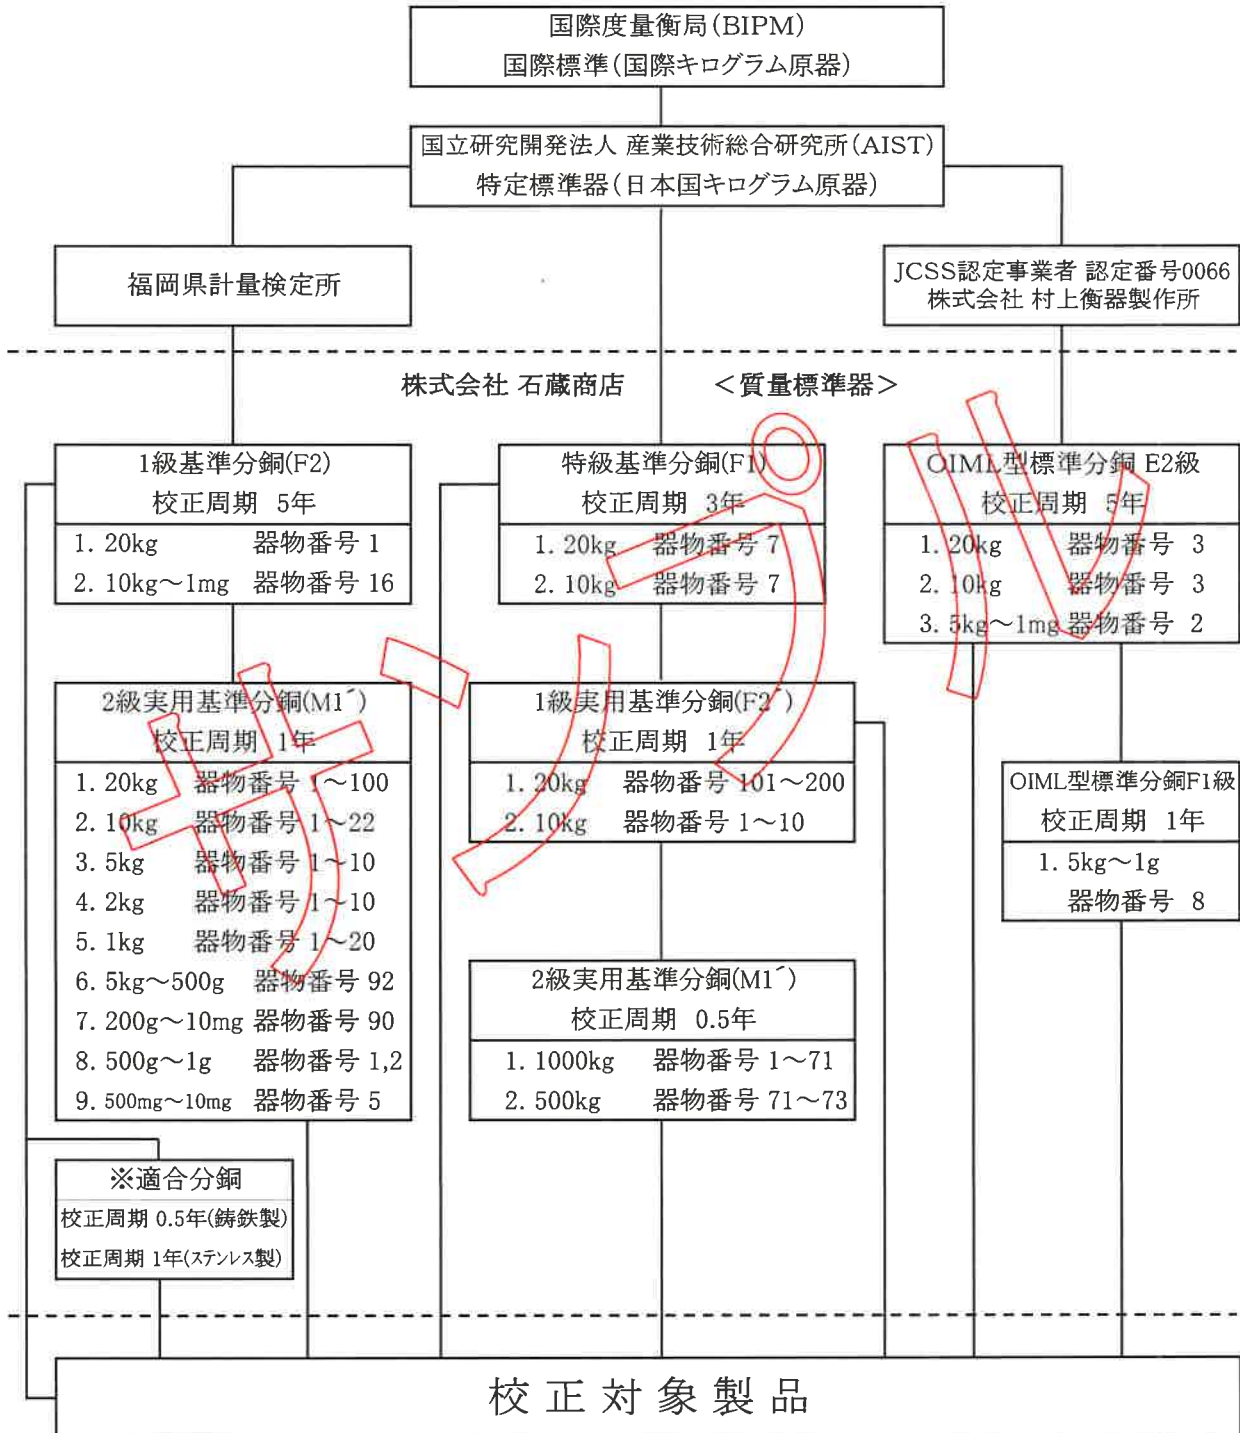

※適合分銅とは、計量法・基準器検査規則で定められた内容に適合した事を弊社が保証する分銅